

Audit d'évaluation des pratiques de bionettoyage d'un isolateur de préparations de cytotoxiques selon les Bonnes Pratiques de Préparation 2022 suite au retour de prélèvements de surfaces bactériologiques positifs

Mathilde Murer¹ ; Céline Ragazzon¹ ; Angélique Marchaud¹ ; Elise Gravier¹ ; Isabelle Grange¹

1 : Pharmacie, CH Emile Roux, le Puy-en -Velay


Contexte

Activité de l'Unité de Reconstitution des Cytotoxiques en augmentation depuis 2015.
Trois nouveaux Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH) formé sur 18 mois.
En septembre 2023, **deux prélèvements bactériologiques** dans l'isolateur sont revenus **positifs à germes de l'environnement**.
→ Questionnement sur les pratiques des PPH.

Objectifs

Réaliser une **revue des pratiques** des PPH afin de voir si les **étapes décrites dans les Bonnes pratiques de préparation (BPP)** sur l'installation et la désinstallation dans l'isolateur sont **bien effectuées**.



Matériel et méthode

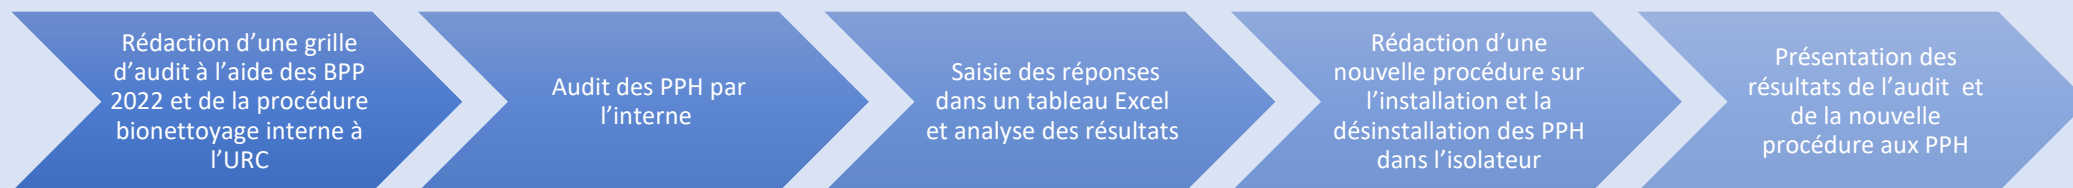

Résultats

Grille d'audit :

- Installation : 3 items et 11 sous-items
- Désinstallation : 3 items et 8 sous-items

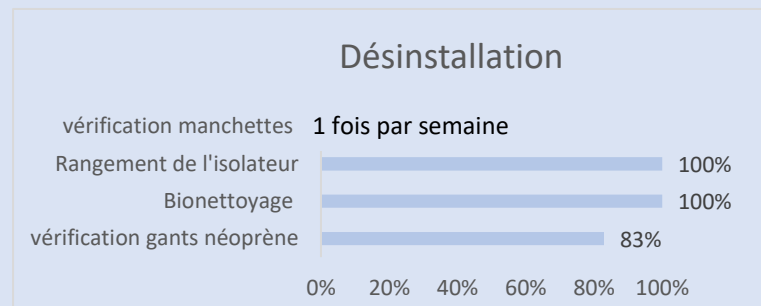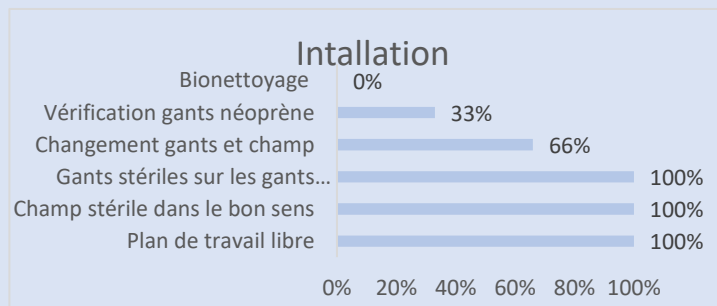

Résultats en pourcentage de préparateur effectuant la tâche

Discussion – Conclusion

Cet audit a permis une **analyse des pratiques des PPH** lors de leur installation et leur désinstallation dans l'isolateur.
Certaines étapes n'étaient pas réalisées malgré plusieurs rappels de leur importance comme le bionettoyage et la vérification de l'intégrité des manchettes et gants néoprène en début et fin de poste.
La rédaction d'une procédure sur l'installation et la désinstallation dans l'isolateur et d'une **check liste de suivi** ainsi **qu'une formation des agents de l'URC** a eu lieu ce qui a permis de **rappeler les pratiques et leur intérêt**. Une analyse de risque a été effectuée avec l'équipe opérationnelle d'hygiène et une procédure de conduite à tenir en cas de prélèvements positifs a été établie.
→ **L'audit devra être reproduit afin d'assurer un suivi et limiter les dérives de pratique**.